


An alle Stationen und Ambulanzen

Zentrallabor: Umstellung des Cholinesterase (CHE) Assay ab dem 24.01.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

da die Fa. Siemens die Produktion ihres derzeitigen Cholinesterase (CHE) Assays einstellt, werden wir ab dem 24.01.2024 die Bestimmung mit einem aktualisierten CHE2 Assay der Fa. Siemens durchführen. Das Analysensystem Atellica CH der Fa. Siemens bleibt unverändert.

Wir haben Vergleichsmessungen zwischen dem bisherigen CHE und dem neuen CHE2 Assay durchgeführt (siehe untenstehende Auswertung).

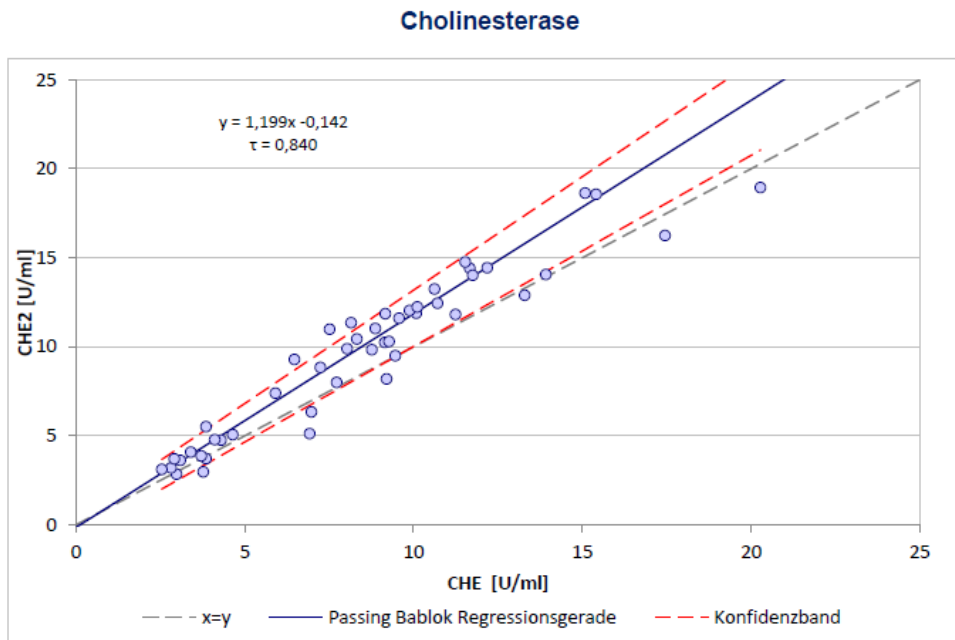

Die Meßwerte des neuen CHE2 Assays liegen somit ca. 20% höher im Vergleich zum bisherigen CHE Test. Der Referenzbereich für Erwachsene gemäß Herstellerangaben beträgt 7,0 – 19,0 U/ml.

Bei der elektronischen Laboranforderung mittels Medico oder Lauris ergeben sich keine Änderungen. Die bisherige CHE Anforderung wird automatisch durch die neue ersetzt.

Zentrallabor
akkreditiert nach
DIN EN ISO 15189



Leiter: Dr. med. M. Wichert

Tel. +49 (0) 201 723 5040

Fax +49 (0) 201 723 5057

marc.wichert@uk-essen.de

Sekretariat:

Dorothee Hausmann

Tel. +49 (0) 201 723 2301

Fax +49 (0) 201 723 5052

Zentrallabor 1. OG, Zimmer 1.03

22. Januar 2024

Seite 1 von 2

Universitätsklinikum Essen
Hufelandstraße 55
45147 Essen

Tel. +49 (0) 201 723 0

Fax +49 (0) 201 723 46 94

info@uk-essen.de

www.uk-essen.de

Für weiterführende Informationen steht Ihnen der AvD unter Tel. 85661 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Wichert', written in a cursive style.

Dr. med. M. Wichert
Leiter Zentrallabor